

speCtra

سيكترا 9 بلس

مضخة ثدي الكهربائية

مضخة ثدي قابلة للشحن

تعليمات الإستخدام

CE
2460



المحتويات

3	1. معلومات هامة للوقاية
4	2. رموز مهمة
4	3. تعليمات الإستخدام
4	4. دليل الضَّخ
5	5. الأجزاء والتجمیع
7	6. كيفية إستخدام مضخة ثدي سبیکترا 9 بلس
7	7. شاشة الـ "إل سي دي" ورِّ التحكم
7	8. معلومات البطارية
8	9. كيفية مضاعفة الضَّخ
8	10. التنظيف والتطهير
8	11. كيفية حفظ لبن الثدي
9	12. كيفية تذويب وإستخدام لبن الثدي المحفوظ
10	13. إستكشاف الأعطال وإصلاحها
11	14. بيئة الإستخدام والتخزين
11	15. المواصفات
	16. الضمان المحدود
	17. الوكيل الإمارati الحصري المعتمد

1. معلومات هامة للوقاية

يتعين قراءة جميع التعليمات قبل الإستخدام.

يتعين دائمًا إتباع احتياطات السلامة الأساسية، عند إستخدام المنتجات الكهربائية!



لتقليل خطر الكهرباء.



1. ينبغي عدم إستخدام الجهاز أثناء الإستحمام.

2. ينبغي عدم وضع الجهاز في مكان ما يتضمن إمكانية سقوطه أو سحبه.

3. ينبغي تجنب وضع الجهاز أو إسقاطه في السوائل الأخرى.

4. ينبغي عدم ملامسة الجهاز الذي سقط في الماء، حيث يتعين فصل المنتج من الكهرباء فوراً.

5. لا تتجاوز 5 دقائق في الميكروويف، لا تغمر الجسم الرئيسي في الماء أبداً.

لتقليل خطر الحروق أو الصعق بالكهرباء أو الحرائق أو إصابة الأفراد



1. ينبغي عدم ترك هذا المنتج بدون مراقبة عند توصيله بالكهرباء.

2. ينبغي وجود إشراف عن قرب في حالة إستخدام هذا المنتج بالقرب من الرضع أو الأطفال.

3. ينبغي إستخدام هذا المنتج فقط للغرض المحدد له كما هو موضح في هذا الدليل، ولا يجوز إستخدام المرفقات غير الموصي بها من قبل شركة يوزين ميديكير.

4. ينبغي عدم إستخدام هذا المنتج في حالة تلف الكابل أو المقبس، أو إذا كان هذا المنتج لا يعمل بشكل صحيح، أو إذا تم إسقاطه أو تعرضه للتلف، أو إذا سقط في الماء، أو إذا كانت أي أجزاء منه مكسورة أو مفقودة.

5. ينبغي إبعاد الكابل عن الأسطح الساخنة.

6. ينبغي عدم إستخدام الجهاز أثناء النوم أو الشعور بالنعاس.

7. ينبغي عدم إستخدام في الهواء الطلق أو في حالة وجود رذاذ بهاء جوي، أو في أماكن سخانة المنتجات أو في أماكن إدارة الأكسجين.

8. ينبغي فصل كابل المحوّل التيار المتردد / التيار المستمر من مقبس الإمداد بالكهرباء في حالة عدم الإستخدام.

9. ينبغي عدم تفكيك أو تعديل المنتج.

10. ينبغي عدم استنشاق أو ابتلاع الأجزاء الصغيرة.

11. قد تحدث ردود فعل تحسسية.

12. قد يؤثّر الوبير والغبار والضوء (بما في ذلك ضوء الشمس) وغيرها بشكلٍ عكسي على السلامة والأداء الأساسي.

13. ينبغي وضع محول التيار المستمر / التيار المباشر في وضع مناسب ليُسهل فصله عن الكهرباء خلال الإستخدام.

إذا شعرت بألم في الثدي أو الحلمة، يتعين عليك إيقاف تشغيل المضخة،

وفصل المحوّل عن الكهرباء، وإزالته من الثدي. ينبغي استشارة أخصائي الرعاية الصحية (يمكن إيقاف الشفط من خلال إدخال الإصبع بين غطاء الثدي والصدر أو من خلال إيقاف تشغيل المضخة).

2. رموز مهمة

علامة الحظر العام		خطر، تحذير		علامة الإجراء العام	
الفئة الثانية		تيار مباشر		نوع الجسم الطافي	
الجهة المصنعة		الرجوع إلى تعليمات الإستخدام		فتح / إغلاق الطاقة	
الضغط الجوي للتشغيل		درجة حرارة التشغيل		نسبة رطوبة التقليل / التخزين / التشغيل	
الرقم المسلسل		الحفاظ على جفاف المنتج		قابل للكسر	
يمنع التكديس		بغي عدم خلط هذا المنتج مع المخلفات التجارية الأخرى من أجل التخلص		تاريخ التصنيع	
شعار الاعتماد الأوروبي		الوكليل الإماراتي الحصري المعتمد		نظام الجودة	

تحذير

هذا المنتج مصمم للإستخدام الشخصي. إستخدام شخص آخر غير المالك الأصلي لمضخة الثدي هذه قد يؤدي إلى مخاطر صحية ومشاكل في الأداء ويلغي ضمان المنتج.

3. تعليمات الإستخدام

هذا المنتج مصمم لمساعدة الأمهات بصورة لطيفة وفعالة على إنتاج لبن الثدي.

4. دليل الضغخ

1. يتم وضع أغطية الثدي المجمعة في المركز فوق الحلمة، ومن المهم أن تكون الحلمة مسحوبة بشكل متساوي في مركز الشفة وألا تحرف في أي اتجاه.
2. يتم الضغط على زر التشغيل / الإيقاف والضغط على زر التدليك "رمز زر التدليك" من أجل وضع التدليك قبل الضغخ.

3. سوف يحث وضع التدليك رد فعل الاسترخاء الذي يحفز بدء تدفق اللبن.

إرشادات - للمساعدة على الاسترخاء، جري كمادات دافئة على الثدي قبل الفexion، واجعل تفكيرك مُنصب على طفلك، واسترخي، سوف يساعد ذلك على تدفق اللبن. تدليك المنطقة العليا من الثدي يمكن أن يساعد أيضاً على السحب من الثدي.

4. بمجرد بدء اللبن في التدفق، اضغط على زر التدليك مرة أخرى للتحويل إلى وضع العصر.

5. قومي بضبط الشفط والدائرة لإيجاد الإعداد المفضل لك.


6. شفط اللبن من كل ثدي لمدة 10 – 15 دقيقة. إذا كان الضخ بشدي واحد، ينبغي تبديل الثدي.

7. اغلق المضخة بعد بضعة ثوانٍ من انتهاء الضخ.

إرشادات - الأكثر فاعلية أن يتم الضخ لوقت أقصر وفاصل زمنية متكررة عن الضخ لوقت أطول وفاصل زمنية أكبر، إذا كنت تصحي بشكل حصري، نقترح الضخ كل 2 – 3 ساعات، 8 مرات على الأقل للحفاظ على الإدرار.

ملاحظة: بالرغم من استخدامك لمضخة الثدي، أرضعي طفلك بنفسك كلما استطعت ذلك. ارضعي دائمًا طفلك من ثديك مباشرةً حالما يكون في استطاعتك، حتى عندما تستخدمي هذا المنتج. اطلبني من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك نصيحة شخصية للحالة الخاصة بك.


5. الأجزاء والتجميع

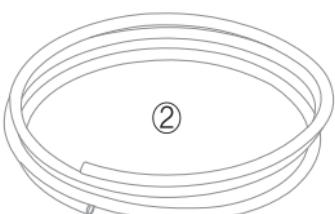

إذا أصبح الأنبوب به غيام أو كان متتسخ يجب استبداله


ترتيب التجميع () () () () () () () ()

- (1) وحدة المضخة (2) الأنابيب (3) حامي من التدفق العكسي
- (4) غطاء الثدي (5) صمام السيليكون (6) الزجاجة (7) الغطاء
- (8) المشبك (9) غطاء القرص (10) القرص (11) المحول




استخدمي القماش الرطب
(غير المبلل) لتنظيف جسم المضخة

القطع المستعملة (قد تختلف القطع تبعاً لكل بلد)

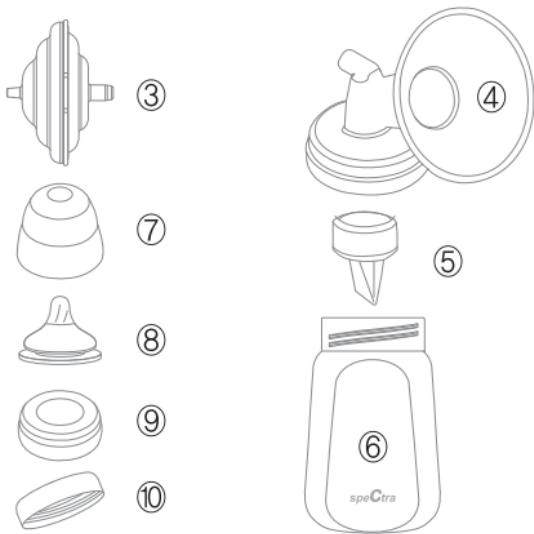

قبل استخدام مضخة الثدي سبيكترا 9 بلس لأول مرة، عقمي مجموعة غطاء الثدي بإستخدام طريقة التعقيم المفضلة لك. [قد تتشقى القطع إذا تم غليها لأكثر من 5 دقائق].


كيفية تجميع الواقي من التدفق العكسي.

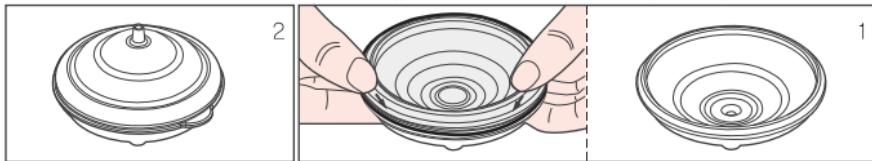


1. أدخل صمام السيليكون في قطعة الحماية السفلية.

2. ادخل الجزء العلوي في صمام السيليكون المجمع.

• أسماء القطع

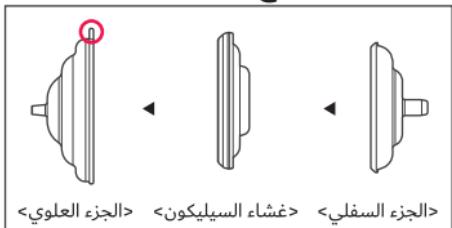

• كيفية التفكيك

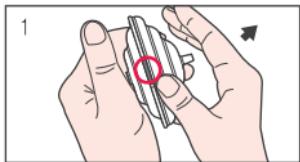

1. بعد تثبيت الجزء السفلي بالإيهام كما في الصورة أعلاه، اسحب الجزء العلوي في اتجاه الأسهم لتفكيك القطع

6. كيفية استخدام مضخة الثدي سبيكترا 9 بلس.

1. تنظيف الوحدة وتوصيل الكهرباء.
2. توصيل الأنابيب بغضاء الثدي وتجميع الزجاجة مع غطاء الثدي.
3. ضبط قوة الشفط عند أقل موضع.
4. ضبط الحملة في مركز غطاء الثدي وتشغيل الوحدة.
5. ضبط قوة الشفط بما يلائم.
6. إغلاق الوحدة بعد الإستخدام.



7. شاشة الـ "إل سي دي" ورر التحكم



8. معلومات البطارية

قد تؤدي البطارية المستخدمة في هذا الجهاز إلى خطر الحرائق والاحتراق الكيميائي إذا تعرضت لاسعة الإستخدام. يُمنع التفكيك وتعريض الجهاز للحرارة والحرق. يُمنع التفكيك وتعريض النار.

مواصفات البطارية	البطارية: 7.4 فولت 900 أمبير ليثيوم - بوليمر
مؤشر البطارية 3 أعمدة على الشاشة	سيعمل لمدة ساعتين
مؤشر البطارية 1 عمود على الشاشة	سيعمل لمدة نصف ساعة
وميض مؤشر البطارية	سيعمل لمدة أقل من 30 دقيقة، تحتاج للشحن

9. كيفية استخدام الفضخ المزدوج



10. التنظيف والتطهير

الاستخدام لأول مرة

تعقيم جميع أجزاء وحدة غطاء الثدي باستثناء الأنبوب بإستخدام طريقة التعقيم المفضلة لك. لا تحتاج إلى تعقيم الأنبوب حيث لن تكون متصلة بلبن الثدي. لا تعقم جسم المضخة.

الاستخدام لأكثر من مرة

تفكك وغسل جميع أجزاء وحدة غطاء الثدي التي تتصل بشيك ولبن الثدي والغسيل بالماء الدافئ والصابون، ثم الشطف بالماء النقي والتجفيف بالهواء. احفظ القطع مغطاة في حالة عدم الاستخدام.

لا تحتاج مكونات إرضاع الرضيع المستخدمة مع لبن الثدي للتعقيم في كل إستخدام. إلا أنه قد ترغب في التعقيم كل بضعة إستخدامات كاحتياط صحي وإزالة بقايا الدهون.

يمكن غسل جميع الأجزاء في غسالة الأطباق.

إذا لزم الأمر يمكن تنظيف جسم المضخة بقطعة قماش رطبة (غير مبتلة)

ملاحظة: لإزالة التكتلات أو اللبن من الأنبوب، أغسلها وجففها فوراً. لتنظيف الجسم الرئيسي، مسح الجسم الرئيسي بقطعة قماش رطبة.

11. كيفية حفظ لبن الثدي

- يتعين التأكد من أن يديك نظيفة وجافة قبل التعامل مع لبن الثدي.
- يجب تعقيم عبوات الحفظ قبل إستخدامها في حفظ لبن الثدي. إذا كنت تنوی حفظ لبن الثدي الخاص بك في نفس الزجاجة أو العبوة التي جمعت بها اللبن، تأكد من تعقيمها قبل الإستخدام. يجب أن تكون أكياس سبيكترا لحافظة للبن معقمة مسبقاً.
- يتعين محاولة عدم لمس عبوات الحفظ من الداخل.
- يتعين إحكام إغلاق العبوة بغطاء صلب أو تأمين قفل السحاب في حالة إستخدام أكياس سبيكترا لحافظة للبن. يتم وضع ملصق على كل عبوة بتاريخ ضخ لبن.

- في حالة لبن الثدي الذي سوف يجمد؛ يجب ترك بوصة واحدة على الأقل بين اللبن وغطاء العبوة، حيث يتتمدد اللبن المجمد خلال عملية التجميد.
- يتعين حفظ اللبن بعيد عن باب المجمد أو الثلاجة لتجنب تغير درجة الحرارة الذي قد يُتلف اللبن.

مُدة تخزين لبن الثدي؟

في درجة حرارة الغرفة:

درجة الحرارة	وقت التخزين
15 درجة سليزيوس (60 درجة فهرنهايت)	24 ساعة
26 درجة سليزيوس (79 درجة فهرنهايت)	4 إلى 6 ساعات
30 درجة سليزيوس (86 درجة فهرنهايت)	4 ساعات

في الثلاجة:

درجة الحرارة	وقت التخزين
0-4 درجة سليزيوس (39-32 درجة فهرنهايت)	حتى 8 أيام

ثلاثة التجميد:

النوع	وقت التخزين
مقصورة داخل الثلاجة	حتى 2 أسبوع
بقاعدة مستقلة، أو علوية، أو جنباً إلى جنب، أو فريزر مستقل	3 إلى 4 أشهر
التبريد العميق مع درجة حرارة ثابتة 17 درجة سليزيوس (0 درجة فهرنهايت)	6 إلى 12 شهر

المصدر: الرضاعة أصبحت أسهل في المنزل والعمل، www.womenshealth.gov

12. كيفية تذويب وإستخدام اللبن المحفوظ

- ينبغي دائمًا التأكد من التاريخ الموجود على عبوة اللبن قبل الإستخدام، وينبغي عدم إستخدام اللبن غير المسجل عليه تاريخ، أو اللبن المحفوظ لمدة طويلة للغاية.
- ينبغي تذويب اللبن المجمد في الثلاجة أو تحت الماء البارد الجاري.
- ينبغي تسخين اللبن تحت ماء جاري دافئ وتدوير العبوة برفق لخلط اللبن إذا كان الماء الدافئ غير متوفّر، يتم تسخين وعاء من الماء على الموقد. بمجرد أن يصبح الماء دافئ، دون أن يصل إلى درجة الغليان، يتم رفع الوعاء من على الموقد ووضع عبوة اللبن في الوعاء. ينبغي عدم تدفئة عبوة اللبن مباشرةً فوق الموقد.
- لا ينبغي أبداً إستخدام الميكروويف مع لبن الثدي لأن الميكروويف يمكن أن يتسبّب في تسخين العبوة بحرارة مرتفعة جداً يمكن أن تحرقك أنت أو طفلك.

- ينبع دائمًا اختبار درجة حرارة اللبن على راحة يديك من الداخل قبل إرضاعه إلى طفلك. ويجب أن يكون اللبن دافئ وليس ساخن.
 - بعد التذويب، يتquin عدم حفظ اللبن في الثلاجة أكثر من 24 ساعة.
 - لا ينبغي إعادة تجميد اللبن الذي تم تذويبه أبدًا. تخلصي من اللبن المجمد سابقًا الذي لم يستخدم خلال 24 ساعة

13. استكشاف الأعطال وإصلاحها


الحالة	الأسباب المحتملة	الفحص	الحلول
لا تعمل البطارية مستنذفة	المحول	تحقق ما إذا كان تيار الكهرباء غير متصل أو به تلف.	ضع تيار الكهرباء في القابس، إذا كان تالف، اتصل بجهة التصنيع أو مركز الخدمة أو المكان الذي اشتريت منه.
	أنبوب الهواء	تحقق بعد الشحن.	إذا كانت لا تشحن، اتصل بجهة التصنيع أو مركز الخدمة أو المكان الذي اشتريت منه.
	الصمam	تأكد ما إذا كان بالجسم الأنابيب موصل الرئيسي	صل أنبوب الهواء بالجسم الرئيسي
	الصحيح	تأكد ما إذا كان الصمام موصل بخطاء الثدي بشكل صحيح	فك وأعيد تركيب الصمام بشكل صحيح
	خطاء الهواء	تأكد ما إذا كان خطاء الهواء مغلق	أغلق خطاء الهواء
	مستوى الشفط	تأكد ما إذا كان هناك شفط منخفض على صمام منظم الشفط أو ضوضاء غير معتمد	اتصل بالمكان الذي اشتريت منه المنتج أو المصنوع
	احتلال تجميع الوحدة	افحصي توصيل المجموعة	فك وأعيد التركيب بشكل صحيح
	خطاء الثدي	تأكد ما إذا كان هناك مشكلة في خطاء الثدي	اشتري واستبدل خطاء الثدي
	رأس الصمام	تأكد ما إذا كان هناك تلف في رأس الصمام	استبدل رأس الصمام
وجود ألم	امتصاص عالي جدا	افحص مستوى الامتصاص	أضيّط مستوى الامتصاص على الدرجة الأكثـر انخفاضـا واستشيري أخصـائي الرضاعـة أو طبيـبك.

14. بيئة الاستخدام والتخزين

بيئة الاستخدام



بيئة التخزين

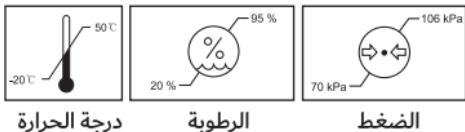

15. المواصفات

الموديل: سبيكترا 9 بلس

نوع الحماية: الفئة الثانية

الوزن: 290 جرام

استهلاك الطاقة: 24 فولت أمبير

المحول

المُصنّع: شركة دونجوان شيلونج فوهوا إلكترويك لمتي.

رقم الموديل: UES18LCP-090140SPA

الداخل: 100 – 240 فولت، 50 / 60 هرتز، 500 أمبير

الخارج: 9 فولت تيار مباشر 1.4 أمبير

البطارية: ليثيوم – بوليمر 7.4 فولت تيار مباشر 900 أمبير

1. نوع الحماية من الصدمة الكهربائية: معدات الفئة الثانية

2. درجة الحماية من الصدمة الكهربائية: نوع الجسم الطافي للأجزاء المستعملة

3. التصنيف وفق درجة الحماية من دخول الماء: آي بي 22

4. هذه الأداة غير مناسبة للاستخدام حول مواد قابلة للاشتعال أو مواد مخدّرة مثل (أنيستيزيا) أو حول غاز الأوكسجين.

5. نمط التشغيل: مستمر

16. الضمان المحدود

هذا المنتج مصمم للإستخدام الشخصي، إستخدام شخص آخر غير المالك الأصلي لمضخة الثدي هذه يؤدي إلى مخاطر صحية ومشاكل في الأداء ويبلغ ضمان المنتج. تضمن هذا المنتج شركة يوزين ميديكيبر، لمشتري التجزئة الأصلي أن يكون المنتج خالي من عيوب المواد والمصنعة لمدة سنتين.

لا يغطي هذا الضمان التلف الناتج عن الحوادث، أو سوء الإستخدام، أو الصيانة غير الملائمة، أو التعديلات غير المصرح بها، أو التوصيل بمصدر كهرباء غير ملائم. سوف يتم دفع تكاليف إصلاح هذه التلفيات.

بطاقة الضمان

سيكيترا 9 بلس

المنشأ: جمهورية كوريا

العنوان: 54, 56, دونجتانساندان، 5 - جي اي ال، هواسيونج - سي، جيونجي - دو، 1848، كوريا الجنوبية.

هاتف: +82-70-5228-0983

مضخة الثدي القابلة للشحن سبيكترا 9 بلس	
الاسم	
الهاتف	
الهاتف الجوال	
العنوان	

17. الوكيل الإماراتي الحصري المعتمد



Masai Medical Equipment Trading
Dubai, United Arab Emirates
Tel.: +971 4 565 791, Mob.: +971 58 590 5103
contact@spectrababy.ae
www.spectrababy.ae



Uzinmedicare Co., Ltd.
54, 56, Dongtansandan 5-gil, Hwaseong-si,
Gyeonggi-do, 18487, Republic of Korea
Tel.: +82-70-5228-0983
www.uzinmedicare.com

