

سبيكترا ويرابل

تعليمات الاستخدام

المحتويات

02. أشياء يجب معرفتها قبل الاستخدام

02. احتياطات السلامة
04. المكونات
05. وصف المنتج و الوظائف الإضافية

06. طريقة الاستخدام

06. ما يجب القيام به قبل الاستخدام
07. طريقة التنظيف و التجميع قبل الاستخدام
08. طريقة التجميع
09. طريقة الاستخدام

11. استكشاف الأخطاء و إصلاحها

11. الإجراءات في حالة التدفق العكسي الفحص الذاتي

12. بيئة الاستخدام و التخزين

13. المواصفات

14. ضمان محدود

أشياء يجب معرفتها قبل الاستخدام

• احتياطات السلامة

1. احتياطات عامة

هذا الجهاز طبي ومخصص للاستخدام الشخصي

- يُرجى توخي الحذر عند مشاركة هذا الجهاز مع أشخاص آخرين، حيث قد تحدث مشاكل مثل العدوى المتقاطعة.
- جميع المكونات الأخرى باستثناء الجسم الرئيسي لمضخة الثدي القابلة للارتداء تعتبر مواد قابلة للاستهلاك. ونظرًا لتلامس هذا الجهاز مع حليب الثدي، يجب على المستخدم استخدامه/الحفاظ عليه نظيفًا، وعدم مشاركته مع الآخرين.
- يُرجى استخدام مكونات أصلية من نوع سبيكترا فقط. إذا لم يتم استخدام مكونات أصلية، فقد تحدث مشاكل مثل ارتجاع الحليب.
- الفترة الموصى بها لاستخدام المكونات هي 3 أشهر. وقد تختلف فترة الاستخدام حسب بيئة المستخدم وتكرار الاستخدام.
- الرموز التي يجب على المستخدمين الانتباه لها عند استخدام الجهاز، هي كالتالي:



أشياء يجب معرفتها قبل الاستخدام

2. الأمور الأساسية

1) مضخة الثدي جهاز للاستخدام الشخصي. يجب الحفاظ على معايير النظافة. إذا استخدمت منتجًا مستعملًا أو منتجًا مؤجرًا، فعليك الانتباه إلى مخاطر فترة الضمان أو العدوى المتقاطعة.
2) يحتوي المنتج على وظيفة إيقاف تلقائي بعد تشغيله لمدة 30 دقيقة. ومع ذلك، إذا شعرت بالنعاس أو غفوت، يجب التوقف عن استخدام المنتج فورًا.
3) إذا امتلأت زجاجة التغذية بحليب الثدي، قد يحدث ارتجاع. لذلك، احرص على عدم ملء زجاجة التغذية بالكامل بحليب
4) الثدي. قد يشعر المستخدم ببعض الانزعاج (وليس الألم) في المراحل الأولى من استخدام مضخة الثدي. إذا استمر الألم، أو إذا كان هناك تشقق أو نزيف في الحلمات، يجب مراجعة الطبيب فورًا.

3. سلامة المنتج

1) حافظ على جفاف المنتج ولا تغمره في الماء أو أي سوائل أخرى.
2) تجنب ملامسة المنتج للمشعات الحرارية أو اللهب.
3) لا تسقط المنتج.
4) لا تستخدم منتجًا تالفًا.


4. اجراءات السلامة المتعلقة بالكهرباء

1) استخدم يديك جافتين عند توصيل أو فصل المحول.
2) استخدم فقط المحول المزود مع المنتج.
3) إذا تعرض المنتج للبلل، استخدمه فقط بعد إجراء الصيانة.
4) لا تستخدم المنتج أثناء الاستحمام أو الاغتسال.


أشياء يجب معرفتها قبل الاستخدام

- **المكونات**

مكونات مضخة الثدي

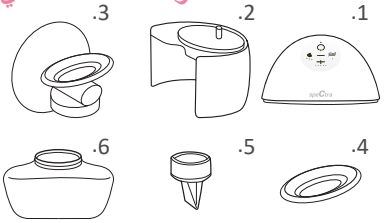


مكونات اخرى

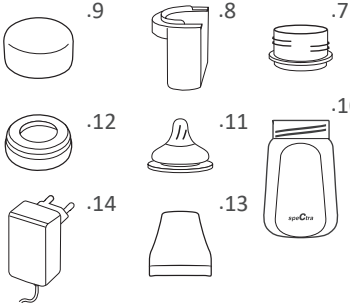

01. مضخة الثدي القابلة للارتداء
02. غطاء يربط بين الجسم الرئيسي والقُمع
03. درع الثدي - جزء يُثبت على الثدي لسحب الحليب
04. غشاء سيليكوني - يُركّب على درع الثدي لمنع ارتجاع الحليب إلى الجسم الرئيسي
05. صمام سيليكوني - صمام يضخ الحليب إلى الزجاجة
06. زجاجة - زجاجة تُستخدم لتجميع الحليب المسحوب
07. موصل الزجاجة - يُستخدم عند تركيب غطاء لولبي أو غطاء محكم الإغلاق على الزجاجة
08. دبوس التوصيل - يساعد في تثبيت زجاجة التغذية وموصل الزجاجة بإحكام أكبر
09. غطاء محكم - غطاء يُغلق الزجاجة لتخزين الحليب مباشرة (متوافق مع زجاجات التغذية أو زجاجة سبيكترا PP)
10. زجاجة PP - زجاجة تُستخدم لتخزين وإرضاع الحليب المسحوب
11. حلمة رضاعة - تُستخدم بعد توصيلها بالغطاء اللولبي لإرضاع الحليب المسحوب
12. غطاء - الغطاء الأوسط الذي يربط الحلمة بزجاجة التغذية
13. الغطاء الخارجي - غطاء الزجاجة
14. محول كهربائي - جهاز يزود مضخة الثدي بالطاقة

أشياء يجب معرفتها قبل الاستخدام

شرح المظهر الخارجي والوظائف الإضافية

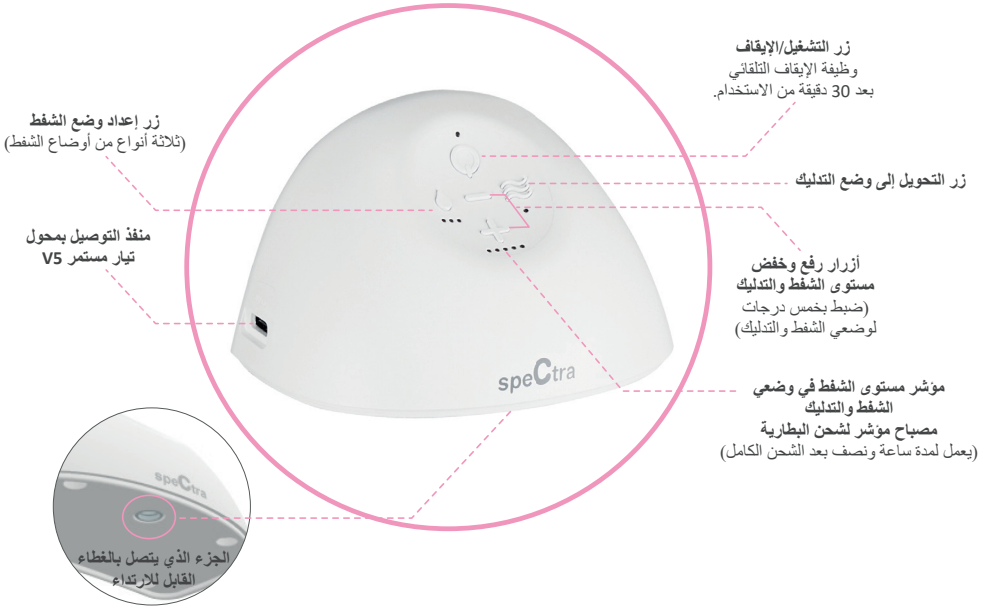


طريقة الاستخدام

ما يجب فعله قبل الاستخدام

1) قبل الاستخدام، اغسل يديك جيدًا وجففهما تمامًا. تأكد أيضًا قبل شفط الحليب من أن الثديين نظيفان وجافان ولا توجد أي مواد غريبة عليهما.

2) قبل الاستخدام، تحقق من أن المكونات التي تلامس حليب الأم قد تم تنظيفها وتعقيمها بشكل صحيح، وقم بتجميع المكونات وفقًا للطريقة الموضحة في دليل المستخدم.

3) إذا لم تستخدم مضخة الثدي بالوضعية الصحيحة، فقد يتدفق الحليب إلى الخلف، لذا يجب الحفاظ على الوضعية الصحيحة أثناء شفط الحليب.

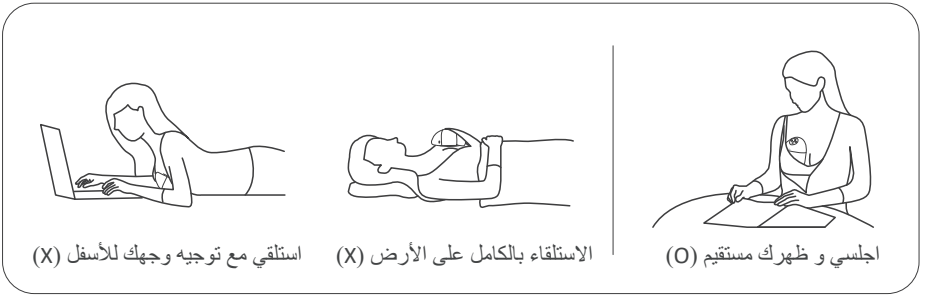

طريقة الاستخدام

طريقة التنظيف والتجميع قبل الاستخدام


1. طريقة التنظيف

1) لا تغسل الجسم الرئيسي أو المحول، وامسحهما بمنشفة جافة.
2) الأجزاء الأخرى قابلة للغسل. بعد فصلها، اغسلها بمنظف زجاجات الرضاعة.
المكونات: الغطاء، درع الثدي، الغشاء السيليكوني، الصمام السيليكوني ، الزجاجة، موصل الزجاجة، دبوس الموصل، الغطاء المحكم، غطاء البرغي، زجاجة PP، الحلمة، الغطاء المحكم.
بعد الغسل، يعتبر التعقيم بالماء المغلي أمرًا شائعًا، ولكن قد تختلف طريقة التعقيم حسب نوع المادة المستخدمة.
3) عند التعقيم بالماء المغلي، يجب الالتزام الصارم بمدة التعقيم حسب نوع المادة:
4)

PA (الزجاجة): في غضون 3 دقائق
PP (جميع المواد البلاستيكية ما عدا الزجاجة): دقيقة واحدة
سيليكون (الغشاء السيليكوني، الصمام السيليكوني، الحلمة): في غضون 30 ثانية

5) بعد التعقيم بالماء المغلي، اشطف الأجزاء عدة مرات بالماء النظيف واتركها لتجف بالهواء.
6) احتفظ بالأجزاء مغطاة عند عدم الاستخدام.
7) قد يحدث تشوه أو تغير في اللون نتيجة التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية لفترات طويلة. لا داعي للقلق، حيث لا يوجد تغيير في الخصائص أو مشكلة في المنتج.

2. طريقة التجميع

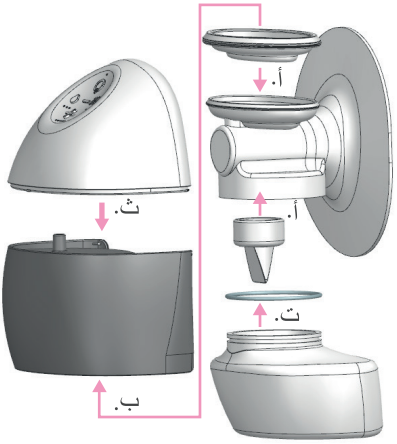


(أ) أدخل صمام السيليكون والغشاء السيليكوني في درع الثدي.
(ب) قم بتركيب الغطاء القابل للارتداء مع درع الثدي.
(ت) أدخل الزجاجة في درع الثدي.
(ث) قم بتوصيل درع الثدي المُجمّع بمضخة الثدي وابدأ باستخدام المنتج.

طريقة الاستخدام

2. طريقة الاستخدام

1) اغسل يديك وامسح الثدي بمنشفة دافئة. يُمنع استخدام الكحول.
2) ثبّت المنتج على الثدي، مع التأكد من أن الحلمة في منتصف الأنبوب الداخلي للقمع.
3) ثبّت المنتج على الثدي باستخدام حمالة صدر مخصصة للرضاعة، وتأكد من أن الحمالة مناسبة ومشدودة بشكل جيد.
4) اضغط على زر تشغيل الجهاز. سيبدأ الجهاز بالإعدادات المستخدمة مسبقًا والمخزنة في الذاكرة. تحقق من مستوى الشفط قبل الاستخدام للتأكد من أنه ليس عاليًا جدًا.
5) اضغط على زر تحويل وضع التدليك لبدء تدليك الثدي قبل الضخ.
6) في وضع التدليك، يمكنك ضبط مستوى التدليك باستخدام زر + أو -. (من المستوى 1 إلى 5)
7) بعد تدليك الثدي بشكل كافٍ، اضغط على زر تحويل الوضع للانتقال إلى وضع الضخ.
8) يوجد 3 أوضاع للضخ. اختر الوضع المناسب لك، ثم اضغط على + أو - لضبط مستوى الشفط. (3 أوضاع مختلفة، وكل وضع يحتوي على 5 مستويات من الشفط)

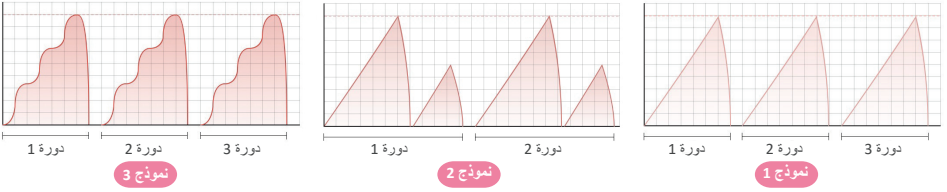


9) عند الانتهاء من الضخ، قم بخفض مستوى الشفط وأوقف تشغيل الجهاز، ثم انحنِ بجسمك إلى الأمام وأدخل إصبعك بلطف في القمع الملتصق بالثدي لفصله ببطء.

طريقة الاستخدام


يمكنك إرضاع الطفل مباشرة بعد الضخ أو تخزين الحليب في زجاجة رضاعة أو كيس تخزين الحليب لاستخدامه لاحقًا.

※ **في هذه الحالة، تأكد من توصيل الجزء العلوي من رأس الموصل بحيث يغطي الموصل بالكامل.**

أ. الإرضاع مباشرةً

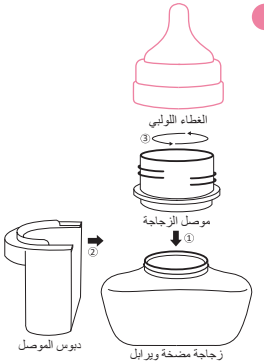

ب. حفظ الحليب

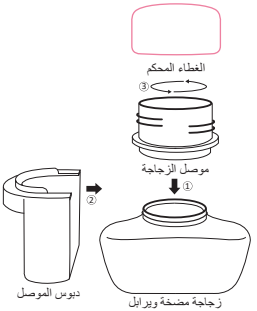

• طريقة التنظيف والتخزين بعد الاستخدام

1) بعد كل استخدام، فك جميع الأجزاء التي لامست الحليب حسب دليل الاستخدام، واغسلها جيدًا بماء جارٍ باستخدام منظف خاص بزجاجات الرضاعة لضمان إزالة أي بقايا.
2) لمزيد من التفاصيل حول التنظيف، راجع قسم "طريقة التنظيف والتجميع قبل الاستخدام".
   بعد الغسل والتعقيم، اترك جميع الأجزاء لتجف تمامًا في الهواء. خزّنها في علبة نظيفة أو مكان نظيف، وكن حذرًا من
3) لمس الأجزاء التي تلامس الحليب حتى جلسة الضخ التالية.

• لإجراءات في حالة التدفق العكسي

إذا كان هناك اشتباه بأن حليب الأم قد عاد إلى الجسم الرئيسي للجهاز، توقف فورًا عن استخدام الجهاز، واتصل بمركز خدمة العملاء الخاص بالشركة للتأكد من أن المنتج يعمل بشكل سليم.

• الفحص الذاتي

س. لا يحدث ضغط الشفط في مضخة الثدي أو يبدو أنه قد انخفض؟

ج. في حال تلف صمام السيليكون، قد ينخفض الفراغ. تحقق من عدم وجود تمزق في صمام السيليكون وكن حذرًا عند التنظيف.

ج. تأكد من أن صمام السيليكون لم ينزلق. إذا تراكمت دهون حليب الأم على أحد المكونات، فقد ينزلق صمام السيليكون. الرجاء تنظيف/تعقيم الجزء الموصل لصمام السيليكون والجزء الداخلي للصمام باستخدام منظف.

ج. بعد التحقق من أن الغشاء السيليكوني مركب بشكل صحيح، حاول إعادة تركيبه.

ج. إذا واصلت استخدام مضخة الثدي لفترة طويلة، قد تشعرين بانخفاض في قوة الشفط نتيجة لتغير استجابة الغدد الثديية. في هذه الحالة، جرب زيادة مستوى الضغط.


إذا لم تُحل المشكلة حتى بعد تنفيذ خطوات الفحص الذاتي المذكورة أعلاه، يرجى التواصل مع مركز خدمة العملاء.

الحالة	الأسباب المحتملة	الفحص	الحلول
لا توجد طاقة	نفاد البطارية	التحقق من مؤشر البطارية	باستخدام سلك الطاقة/محول التيار المتردد، قم بتوصيل المضخة بمصدر طاقة مناسب.
لا يوجد شفط	صمام السيليكون	تحقق من أن الصمام متصل بدرع الثدي بشكل صحيح	قم بتركيب الصمام بدرع الثدي - لفت الصمام داخل درع الثدي للتركيب. إذا كان هناك تمزق/تلف في الصمام، تحقق منه.
شفط ضعيف	مستوى الشفط	تحقق من مستوى الشفط	قم بزيادة مستوى الشفط.
	صمام السيليكون	تحقق من وجود تمزق أو تلف في صمام السيليكون	استبدل صمام السيليكون
ألم	مستوى الشفط	مستوى الشفط مرتفع جدًا	اضبط الجهاز على مستوى شفط أقل.

• بيئة الاستخدام و التخزين



بيئة الاستخدام

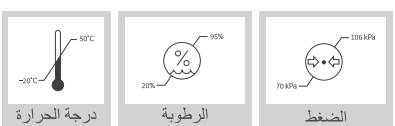

بيئة التخزين

المواصفات

نوع الحماية: الفئة الثانية
الوزن: 305g
العمر الافتراضي المتوقع لجهاز سبيكترا ويرابل: 3 سنوات
يجب استخدام المحول التالي:
المدخل: 100-240 V~50/60Hz, 500 mA
المخرج:5V ⎓ 2A
البطارية: Li-Polymer 3.7V,1,500mAh
1. نوع الحماية من الصدمات الكهربائية: معدات من الفئة الثانية
2. درجة الحماية من الصدمات الكهربائية: أجزاء مطبقة من النوع BF
3. التصنيف حسب درجة الحماية ضد تسرب الماء: IP22
4. هذا الجهاز غير مناسب للاستخدام في بيئة تحتوي على مواد تخدير قابلة للاشتعال أو أكسجين
5. نمط التشغيل: تشغيل مستمر

ضمان محدود

تم تصميم هذا المنتج للاستخدام الشخصي فقط. استخدام مضخة الثدي من قبل شخص غير المالك الأصلي يعرض الصحة والأداء للخطر ويفسخ الضمان.
هذا المنتج مشمول بالضمان من قبل الجهة التي تم الشراء منها في بلدك إلى المشتري الأصلي من جهة البيع بالتجزئة، ضد عيوب المواد والتصنيع لمدة سنة واحدة.
لا يغطي الضمان الأضرار الناتجة عن الحوادث، أو سوء الاستخدام، أو الصيانة غير السليمة، أو التعديلات غير المصرح بها، أو التوصيل بمصدر طاقة غير مناسب.
قد يتم فرض رسوم مقابل إصلاح الأضرار الناتجة عن نظام الشفط.

مضخة الثدي سبيكترا ويرابل	
الاسم	
رقم التواصل	
العنوان	
مكان الشراء	
تاريخ الشراء	

UZ-IFU-WR(EN)
REV.001
2025-06



spectra